NIRFLex N-500 Calibrazione per Panna

Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BÜCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

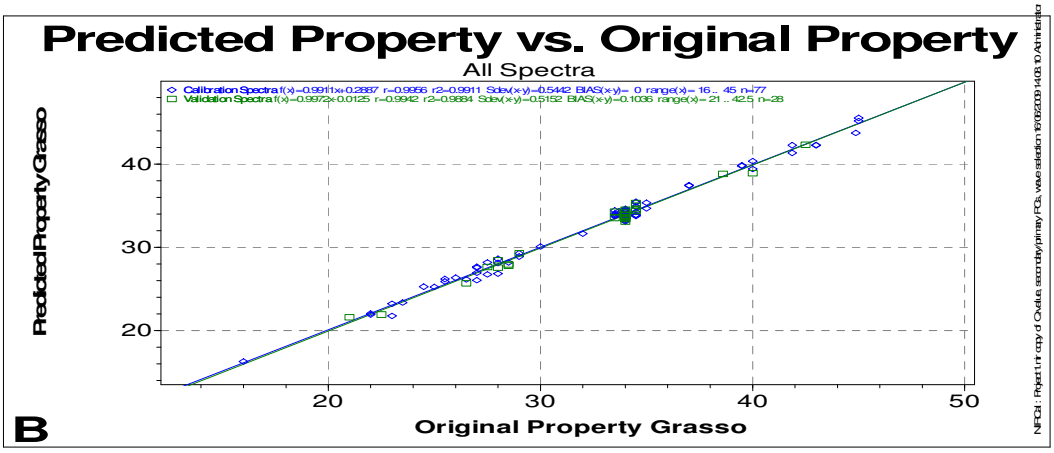

Parametro	Intervallo di misura (%)	Errore standard SEP	Coefficiente correlazione
Grasso	16.0 – 45.0	0.5	0.99

BUCHI Italia S.r.l. Palazzo A4 Strada 4 – 20090 Assago (MI)
Telefono 02 82.45.01 **– Fax** 02 57.51.28.55 **E-mail** italia@buchi.com **Web** www.buchi.it